
EVAC-U-SPLINT® Materasso sottovuoto Linee Guida per l'applicazione

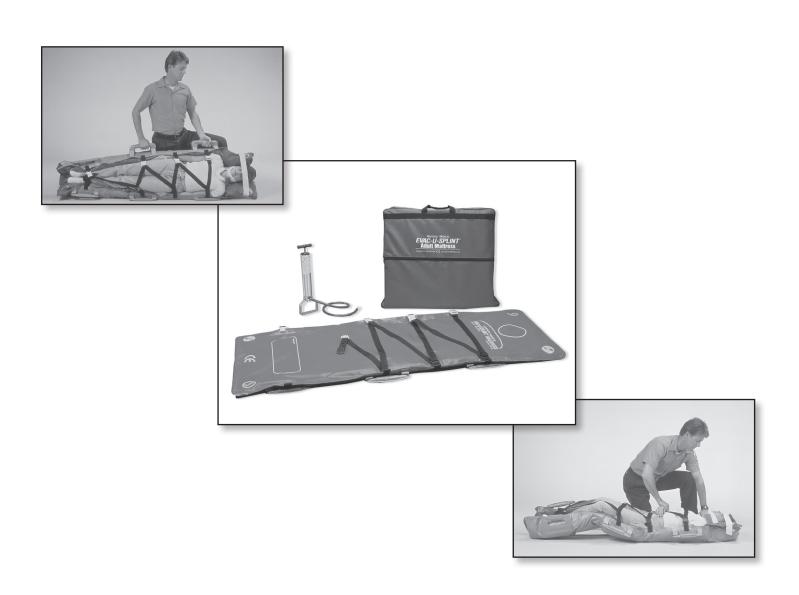

Si applica ai numeri di modello:

MT 1075-6 MT 3075-6 MT 3075-6BP EVS 9075-6C

INTRODUZIONE

Lo scopo del materasso EVAC-U-SPLINT® è fornire una stabilizzazione completa del corpo durante il sollevamento e lo spostamento di un paziente su una barella o una culla per il trasporto. Fornisce un'alternativa alla tavola spinale completa con una rigidità sufficiente per immobilizzare e proteggere un paziente con una sospetta lesione spinale. A differenza di una tavola piatta, il materasso utilizza la tecnologia del vuoto per adattarsi alla forma e ai contorni esatti del corpo del paziente, fornendo una migliore immobilizzazione laterale e assiale ed eliminando il disagio dei punti di pressione associati alla tradizionale immobilizzazione della colonna vertebrale.

Hartwell Medical ha prodotto vari video di formazione che mostrano l'uso e la cura raccomandati del materasso per adulti EVAC-U-SPLINT disponibile sul nostro sito Web (www.HartwellMedical.com).

È richiesto un addestramento pratico "pratico" prima dell'uso di questo dispositivo medico. In caso di domande o se è necessario ulteriore supporto tecnico, contattare il rivenditore locale Hartwell Medical o il servizio clienti Hartwell Medical dalle 8:00 alle 16:30 Pacific Time, dal lunedì al venerdì, al 760-438- 5500. Se si viene a conoscenza di un incidente grave correlato all'uso del dispositivo, è necessario segnalare l'incidente a Hartwell Medical e all'autorità di regolamentazione del dispositivo medico locale.

Queste Linee guida per l'applicazione sono scritte sulla premessa che l'utente di questo dispositivo medico abbia ricevuto formazione e certificazione approvata per il servizio medico di emergenza e operi sotto il controllo e i protocolli medici del medico.

PREPARAZIONE

- 1. Stendere il materasso EVAC-U-SPLINT® su una superficie piana vicino al paziente. Il logo "testa e spalle" indica l'estremità della testa del materasso.
- 2. Rimuovere il cappuccio in vinile rosso con guinzaglio dalla valvola. Rilasciare il vuoto nel materasso premendo lo stelo della valvola rossa. Tenere lo stelo della valvola premuto fino a quando il materasso è flessibile.
- 3. Scollegare la cinghia di contenimento del paziente dal materasso. Oppure, se lo si desidera, scollegare la cinghia solo dal lato del materasso più vicino al paziente.
- 4. Appianare manualmente le perle per formare una superficie piana.
- 5. Collegare la pompa al materasso fissando il connettore del tubo della pompa al MaxiValve™ sul materasso. La pompa può essere fissata all'estremità del piede o all'estremità della testa. NOTA: il materasso pediatrico EVAC-U-SPLINT ha solo una valvola all'estremità dei piedi del materasso. Evacuare abbastanza aria per rendere il materasso semirigido.

L'obiettivo è essere in grado di spostare il materasso come un'unità durante il posizionamento e avere le perline sufficientemente stabilizzate da posizionare il paziente sul materasso senza spingere le perline da un lato. Con la quantità corretta di evacuazione, la superficie del materasso dovrebbe essere liscia, ma non increspata.

Posizionamento e applicazione

- 1. Posizionare il materasso accanto al paziente con la prima fibbia in linea con l'ascella del paziente (ascella). La prima fibbia è posizionata appena sotto il logo "testa e spalle" sul materasso.
- 2. Log-roll del paziente utilizzando le tecniche standard di cura del paziente.
- 3. Avvicinare il materasso alle spalle del paziente, mantenendo la prima fibbia in linea con l'ascella del paziente.
- 4. Portare indietro il paziente sul materasso. Centrare il paziente se necessario. Potrebbe essere più facile far rotolare il paziente sul materasso con la testa del paziente da tre a quattro piedi sotto l'estremità della testa del materasso. È quindi possibile spostare il paziente lungo l'asse lungo del corpo in una posizione centrata sul materasso.
- 5. Aprire la MaxiValve all'estremità dei piedi, consentendo all'aria di entrare. Tenere la MaxiValve aperta fino a quando il materasso si ammorbidisce e inizia a conformarsi alla forma del paziente. Potrebbe essere necessario spostare le sfere lontano o sotto la testa del paziente, a seconda dell'anatomia del paziente. Assicurarsi che ci siano sfere sufficienti per mantenere l'allineamento neutro del paziente. Se necessario, tamponare adeguatamente per garantire un allineamento neutro. Seguire sempre i protocolli medici locali approvati dal proprio direttore medico.

NOTA: un metodo alternativo consiste nell'utilizzare un CombiCarrierII®, una barella a cucchiaio o una barella separabile come mezzo di trasferimento sul Materasso a depressione EVAC-U-SPLINT®. L'uso del CombiCarrierII o della barella a cucchiaio deve essere stabilito dal proprio direttore medico. Se si utilizza il CombiCarrierII o una barella a cucchiaio, si consiglia di evacuare una piccola quantità di aria dal materasso per renderlo flessibile, ma non flaccido, più simile all'argilla da modellare. Posizionare semplicemente il paziente (che è fissato al CombiCarrierII) sul materasso a depressione e quindi rimuovere il CombiCarrierII intorno al paziente. Procedere con le normali procedure di applicazione come segue (vedere pagina 3).



Il posizionamento e l'applicazione sono continuati.

6. Attaccare la cinghia di ritenuta del paziente. Tieni presente che una delle funzioni primarie della cinghia è quella di portare i lati del materasso intorno al corpo del paziente.

Metodo n. 1: inizia dal petto con la prima fibbia e lavora verso i piedi. A zig-zag, attaccare le fibbie nere e le fibbie bianche in modo alternato. Termina attaccando la fibbia nera all'estremità del piede.

Metodo n. 2: attaccare tutte le fibbie nere su un lato del paziente. Quindi seguire attaccando tutte le fibbie bianche sull'altro lato.


NOTA: potrebbe essere utile riporre il materasso a depressione con tutte le fibbie attaccate e poi sganciare solo le fibbie sul lato del materasso che verrà fatto scorrere sotto il paziente. Questo dovrebbe rendere più facile e veloce l'applicazione del materasso sulla scena.

7. Partendo dall'estremità della testa del materasso, rimuovere l'allentamento sollevando al centro di ciascuna sezione della cinghia che copre la distanza tra due fibbie. La cinghia in eccesso viene tirata attraverso la fibbia NERA all'estremità dei piedi del materasso. UN TIRO VIGOROSO DELLA CINGHIA PU CAUSARE LA ROTAZIONE DEL PAZIENTE E / O DEL MATERASSO. CI PU ESSERE EVITATO ALIMENTANDO SEMPRE IL CINTURINO ATTRAVERSO LE FIBBIE MENTRE SI STRINGE IL CINTURINO.

Ripetere la procedura di serraggio della cinghia lavorando dall'estremità della testa verso l'estremità dei piedi del paziente. Se le fibbie all'estremità dei piedi sono molto ravvicinate, può essere più facile rimuovere l'eventuale allentamento in eccesso stringendo la cinghia nella direzione opposta, spostandosi dall'estremità dei piedi verso l'estremità della testa del paziente.

PRESTARE SEMPRE ATTENZIONE QUANDO SI STRINGE LA CINGHIA DI RITENUTA DEL PAZIENTE PER EVITARE COMPROMESSI RESPIRATORI O L'APPLICAZIONE DI PRESSIONE IN QUALSIASI AREA DANNEGGIATA.

- 8. Spingere le sfere lontano dall'area sopra la testa del paziente, ma non alterare il supporto sotto la testa del paziente che mantiene un allineamento neutro. Modellare il materasso intorno alla testa, assicurandosi di riempire i vuoti alle spalle e alla base del collo del paziente. Trasferite la stabilizzazione all'esterno del materasso e continuate a trattenere questi "blocchi di testa" che avete formato fino a quando il materasso non viene evacuato.
- 9. Evacuare l'aria dal materasso, utilizzando la valvola situata all'estremità dei piedi. È possibile utilizzare la valvola di testa, oppure entrambe le valvole contemporaneamente, ma è preferibile utilizzare la valvola di fondo. Ciò rende più facile lavorare intorno alla testa del paziente. In condizioni normali, il La pompa per vuoto manuale EVAC-U-SPLINT® può richiedere fino a 35 corse per ottenere un'immobilizzazione rigida. Ad altitudini più elevate (4.000 piedi +) potrebbe essere necessario utilizzare 40-45 colpi per evacuare completamente il materasso.

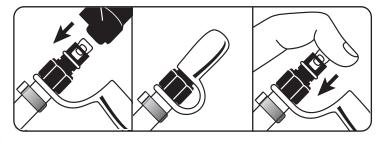

- 10. Per evitare l'apertura accidentale della valvola, ogni volta che un paziente viene spostato nel materasso o quando il materasso viene riposto, assicurarsi di posizionare SEMPRE il CAPPUCCIO ROSSO CON GUINZAGLIO sull'estremità del MaxiValve™.
- 11. Completare il fissaggio della testa del paziente utilizzando nastro adesivo di grado medico.
- 12. Allacciare la cinghia di contenimento del paziente e controllare lo stato neurovascolare del paziente prima di spostare il paziente. Seguire sempre i protocolli medici locali approvati dal proprio direttore medico.

NOTE IMPORTANTI

NON sollevare il materasso EVAC-U-SPLINT® da solo dalle estremità. Utilizzare solo le maniglie di sollevamento del punto di equilibrio. È richiesto un minimo di due persone posizionate ai lati. Le dimensioni e il peso del paziente determineranno il numero di personale necessario per sollevare e spostare correttamente il paziente per il trasporto. Le grandi maniglie su ciascun lato consentono a due soccorritori di afferrare il materasso su ciascun lato. Ciò fornisce quattro punti di supporto su entrambi i lati del materasso per pazienti grandi o molto alti. Per pazienti estremamente pesanti, possono essere necessari dispositivi di supporto aggiuntivi oltre al materasso a depressione.

Di fronte a una situazione che richiede il sollevamento da un'estremità all'altra (cioè, salire o scendere le scale), utilizzare un CombiCarrierII®, una tavola spinale lunga, una barella a cucchiaio o una barella "piatta" sotto il materasso. Il salvataggio verticale richiede l'uso di una barella basket o di un dispositivo simile. Quando si utilizza una barella accessoria, assicurarsi sempre che il materasso a depressione sia fissato alla barella prima di spostare il paziente.

Controllare sempre la rigidità del materasso prima di sollevare il paziente dal lettino dell'ambulanza o da un altro dispositivo di movimentazione del paziente.

Il materasso EVAC-U-SPLINT è compatibile con i raggi X (la MaxiValve è in plastica con una molla interna in acciaio inossidabile).

PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Il materasso e la cinghia di ritenuta del paziente possono essere puliti facilmente utilizzando acqua e sapone, un detergente delicato o un detergente / disinfettante commerciale. Posizionare SEMPRE il cappuccio rosso con guinzaglio all'estremità della MaxiValve prima di pulire il materasso. È possibile utilizzare soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina), ma evitare l'esposizione prolungata del tessuto ad alte concentrazioni di candeggina perché è possibile lo scolorimento. Una soluzione di candeggina all'1-2% non danneggerà il materiale, ma risciacquare SEMPRE accuratamente il materasso dopo la pulizia. Lasciare asciugare il materasso all'aria o con un asciugamano prima di riporre il materasso EVAC-U-SPLINT® nella sua custodia / custodia per il trasporto. Controllare il materasso inizialmente per perdite e dopo ogni utilizzo. Piccole perdite o forature di dimensioni inferiori a 3,2mm possono essere riparate utilizzando il kit di riparazione fornito con il materasso e seguendo queste procedure:

- 1. Applicare una goccia di colla vinilica sul sito di puntura.
- 2. Aspirare una piccola quantità di aria dal materasso per tirare un po 'di colla nel sito della puntura.
- 3. Rilasciare il vuoto permettendo all'aria di entrare nel materasso
- 4. Lasciare asciugare completamente la colla vinilica per 24 ore a temperatura ambiente.

Le riparazioni temporanee sul campo possono essere eseguite utilizzando un piccolo pezzo di nastro adesivo non poroso o nastro adesivo sul sito di puntura. Per fori più grandi di 3,2mm o se avete domande sulle procedure di riparazione, contattateci direttamente al 760-438-5500.

HARTWELL MEDICAL WARRANTY

I materassi EVAC-U-SPLINT® hanno una garanzia limitata di tre anni contro i difetti di materiale e lavorazione. La EVAC-U-SPLINT MaxiValve è garantita a vita. RICORDA DI ATTIVARE LA TUA GARANZIA COMPILANDO UN MODULO DI REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB (www.HartwellMedical.com). Se si necessita di assistenza in base ai termini di questa garanzia, contattare il rivenditore locale Hartwell Medical o il servizio clienti Hartwell Medical al 760-438-5500 durante il normale orario lavorativo.

Hartwell Medical LLC non si assume alcuna responsabilità per usi diversi da quelli qui indicati.

CONSERVAZIONE

Ispezionare sempre il prodotto per rilevare eventuali danni prima di riporlo. Ciò contribuirà a garantire che il materasso a vuoto EVAC-U-SPLINT® sia sempre pronto per l'uso in condizioni di emergenza. Il materasso deve essere conservato in un'area al di sopra del punto di congelamento (0° C). Il materasso può essere utilizzato in ambienti sotto lo zero, fino a -34° C, ma non deve essere conservato in un'area in cui la temperatura è inferiore allo zero. In caso di dubbio, portare il prodotto a una temperatura superiore allo zero prima di utilizzarlo sul campo.

DOCUMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE

Tutti coloro che useranno o faranno funzionare il materasso EVAC-U-SPLINT® dovrebbero essere tenuti a partecipare attivamente alla formazione iniziale ea tutte le successive sessioni di aggiornamento. Ciò garantirà una chiara comprensione della funzione e delle capacità del materasso EVAC-U-SPLINT. Dovresti utilizzare il processo di formazione che è stato approvato dalla tua organizzazione ed è conforme alle linee guida del tuo direttore medico. Gli elementi importanti da documentare dovrebbero essere la data della formazione, i nomi dei partecipanti, il nome e il titolo dell'istruttore e il luogo della formazione

REGISTRO DI MANUTENZIONE

L'ispezione e la manutenzione di routine sono necessarie per mantenere il materasso EVAC-U-SPLINT® pronto per l'uso immediato. Se, in qualsiasi momento, si sospetta che il materasso EVAC-U-SPLINT non funzioni correttamente, deve essere messo fuori servizio fino a quando non può essere accuratamente ispezionato e adeguatamente riparato o sostituito.

EC REP

Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands

CE AGEVAM 07/

HARTWELL MEDICAL

