



FASPLINT® Vakuumskena

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

VIKTIGT: Dessa applikationsriktlinjer är endast avsedda som en vägledning för lämpliga förfaranden som ska användas vid användning av FASPLINT® halveponibel vakuumskena. Du bör **ALLTID** följa de protokoll som fastställts av din lokala medicinska chef. Dessa riktlinjer är för korrekt utbildad och auktoriserad akut medicinsk personal som arbetar under direkt medicinsk övervakning av en licensierad medicinsk läkare.


FASPLINT är utformad för att fungera som en halv engångs vakuum immobiliseringsanordning. Det ger stöd och stabilisering utan att cirkumferentiellt tryck appliceras på det skadade området. FASPLINT bör fungera bra för många patientapplikationer. Produktens livslängd beror på samtalsvolym och skötsel och underhåll av produkten. Som med all medicinsk utrustning och räddningsutrustning bör du alltid kontrollera och kontrollera att produkten är i korrekt skick i början av varje skift och efter varje patientanvändning innan produkten tas i bruk igen. Om du blir medveten om någon allvarlig incident relaterad till användningen av enheten, bör du rapportera händelsen till Hartwell Medical och till din lokala tillsynsmyndigheter för medicintekniska produkter.

FÖRBEREDELSE

Se alltid till att de grundläggande ABC: erna för luftvägar, andning och cirkulation är intakta före eventuella splitteraktiviteter. Ha all din utrustning klar för användning. Detta inkluderar din evakueringskälla (manuell pump eller bärbar sugenhet) samt dina fästmedel (tejp, Kling®, etc.)


SLÅ IN

Håll stöd för det skadade området och applicera skenan genom att linda FASPLINT runt det skadade området så att leden ovanför och fogen under skadeplatsen kommer att immobiliseras. Palpate distala pulser och kontrollera om kapillärpåfyllning före applicering. Se piktogram till höger.

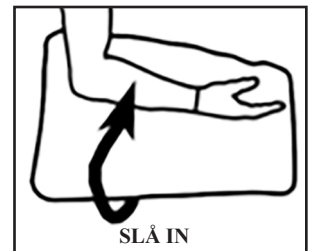

ÖPPEN VENTIL

FASPLINT-ventilen är en enkel push-pull-kolvliknande ventil. När ventilstammen trycks IN stängs ventilen. När ventilstammen dras ut är ventilen ÖPPEN. Öppna ventilen genom att dra i rät vinkelventilförlängningsröret där den ansluts till den röda ventilstammen.

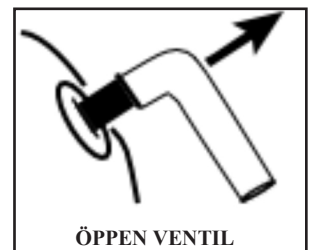


EVAKUERA LUFT

Anslut sugkällan till FASPLINT med ventilen i öppet läge. För in fasplintpumpslangens avsmalnande spets i ventilförlängningsröret med rätt vinkel. Se till att du har en bra anslutning och att ventilen förblir öppen. Evakuer luften från FASPLINT tills skenan bildar en styv gjutning runt det skadade området. (Observera att det finns en avsmalnande spetsadapter som gör att du kan använda en EVAC-U-SPLINT® manuell pump med FASPLINT. Ring oss för mer information.)



STÄNG VENTIL

När önskad fasthet har uppnåtts stänger du ventilen på FASPLINT. TRYCK in ventilstammen för att stänga ventilen. När ventilen är stängd tar du bort sugkällan. Kontrollera FASPLINT igen för fasthet. Om FASPLINT av någon anledning inte behåller sin styva stödjande form, kontrollera skenan igen och evakuer luften från skenan igen och se till att ventilen stängs ordentligt. Om skenan fortfarande inte behåller sin styvhet, ta försiktigt bort skenan och applicera en annan FASPLINT av samma eller större storlek eller annan typ av spjåla för att stabilisera det skadade området på ett säkert sätt.

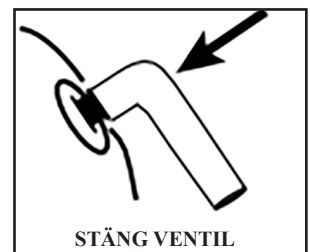



SÄKRA PÅ PLATS

Samtidigt som stödet för FASPLINT, som nu evakueras, bibehålls, kontrollerar de distala pulserna och cirkulationen igen. När distala pulser och cirkulation har bekräftats kan du säkra FASPLINT med tejp eller på annat sätt. Fortsätt att övervaka cirkulationen och sensoriska funktioner på väg till den medicinska anläggningen. Fortsätt också att övervaka **STYVHETEN** och effektiviteten hos FASPLINT under transporten. Gör justeringar om patientens tillstånd ändras. **FÖLJ ALLTID DINA LOKALA MEDICINSKA PROTOKOLL.**

BORTTAGNING

Ta bort fästmaterialet (tejp, kling, etc.) innan du släpper in luft i FASPLINT igen. **KAPA INTE FASPLINT.** Se till att all sjukhuspersonal informeras om dessa avlägsnandeprocedurer. Öppna ventilen och låt luft komma in i skenan. Ta bort skenan.

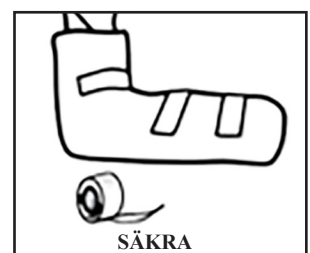



FASPLINT® Vakuumskena

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH REPARATION

Vakuumspljällen rengörs enkelt med tvål och vatten, ett mildt rengöringsmedel eller ett kommersiellt rengöringsmedel/desinfektionsmedel. Stäng ALLTID ventilen innan du rengör skenan. Natriumhypokloritlösningar (blekmedel) kan användas, men undvik långvarig exponering av tyget för höga koncentrationer av blekmedel eftersom missfärgning är möjlig. En 1-2% blekmedelslösning skadar inte materialet, men skölj ALLTID skenan noggrant efter rengöring. Låt skenan lufttorka eller torka handduken innan du placerar FASPLINT® Vakuumspljället i förvarings- / bärväska. Kontrollera spljällen initialt för läckor och efter varje användning. Små läckor eller punkteringar som är mindre än 3mm i storlek kan repareras med hjälp av en av de reparationskit som finns tillgängliga på vår webbplats.

Tillfälliga fältreparationer kan utföras med hjälp av en liten bit icke-porös tejp eller silvertejp över punkteringsstället. För hål större än 3mm eller om du har några frågor om reparationsprocedurer, vänligen kontakta oss direkt på 760-438-5500.

HARTWELL MEDICAL WARRANTY

FASPLINT® extremitetsskotor har 6 månaders begränsad garanti mot defekter i material och utförande. KOM IHÅG ATT AKTIVERA DIN GARANTI GENOM ATT FYLLA I ETT PRODUKTREGISTRERINGSFORMULÄR SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ VÅR WEBBPLATS (www.HartwellMedical.com). Om du behöver service enligt villkoren i denna garanti, kontakta din lokala Hartwell Medical Dealer eller Hartwell Medical Customer Service på 760-438-5500 under normal arbetstid. Hartwell Medical LLC tar inget ansvar för annan användning än vad som anges här.

LAGRING

Kontrollera alltid produkten för skador innan du förvarar den. Detta hjälper till att säkerställa att FASPLINT® Vakuumsplint alltid är redo att användas under nödsituationer. Madrassen ska förvaras i ett område som är över fryspunkten (0°C). Skenan kan användas i miljöer under fryspunkten, ner till (-34°C), men den bör inte förvaras i ett område där temperaturen är under fryspunkten. Om det finns några tvivel, ta produkten till en temperatur som är över fryspunkten innan du använder den på fältet.

DOKUMENTATION AV UTBILDNING

Alla som kommer att använda eller driva FASPLINT® Vacuum Splint bör vara skyldiga att aktivt delta i den inledande utbildningen och alla efterföljande repetitionsutbildningar. Detta kommer att säkerställa en tydlig förståelse för funktionen och kapaciteten hos FASPLINT Vakuumsplint. Du bör använda den utbildningsprocess som har godkänts av din organisation och är i enlighet med din medicinska chefs riktlinjer. Viktiga objekt att dokumentera bör vara utbildningsdatum, namn på deltagare, lärarens namn och titel samt utbildningsplatsen.

UNDERHÅLL LOGGA

Rutininspektion och underhåll krävs för att hålla FASPLINT® Vakuumsplint redo för omedelbar användning. Om FASPLINT Vacuum Splint vid något tillfälle misstänks inte fungera korrekt bör den tas ur drift tills den kan inspekteras noggrant och repareras eller bytas ut på rätt sätt. Som en del av ditt förebyggande underhållsprogram bör du ha en skriftlig logg över allt underhåll som utförs på FASPLINT Vakuumsplint.

HARTWELL MEDICAL



Hartwell Medical

6354 Corte del Abeto, Suite F

Carlsbad, CA 92011 USA

PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783

www.HartwellMedical.com

EC REP

MedEnvoy Global

B.V Prinses

Margrietplantsoen

33 Suite 123

2595 AM The

Hagu

The Netherlands



AGFS 4/24